Certificado de Calibración

Número 40927

Acreditación : LC 018 según requerimientos NCH-ISO 17025, Instituto Nacional de Normalización, INN

Identificación del Cliente

Cliente	: Pinto Piga Seeds S.A.
Dirección	: Parcela San Eduardo Camino Santa Cecilia s/n
Comuna	: El Monte

Laboratorio Calibración

Razón Social	: Precision Servicio S.A.
Dirección	: Avda. El Salto # 4291
Comuna	: Huechuraba
División Metrológica	: Laboratorio de Calibración en la Magnitud Masa

Identificación del Equipo

Tipo de Equipo	: Termobalanza
Fabricada por	: Mettler Toledo
Modelo	: HB 43-S
Número de serie	: B044081992
Número Interno	: HD-02
Plataforma modelo	: ---------
Número de serie plataforma	: ---------
Capacidad Máxima	: 54 g
Rango de utilización	: 10 g
Escalafón Real d	: 0,001 g
Escalafón de Verificación e	: 0,001 g
Clase OIML	: II
Instalada en	: Sala de humedad

Trazabilidad de la Medición y Calibración

Valor Nominal	: B916550577 Set 1mg a 200g E2
Serie	: B916550577
Clase OIML	: E2
Trazabilidad	: Mettler Toledo AG - Suiza
Según certificado numero	: B916550577
Vigencia Set de masas hasta	: 30/04/2024

Condiciones Ambientales de Calibración

Temperatura	: 20.5 ºC
Humedad Relativa	: 50.0 %

Metodo y Fecha de Calibración

Método de Calibración	: Comparación PECEP-01-001 Revisión N° 19, Basado en OIML R76-1 ed.2006 NCh2562. Of 2001, Ley N° 19171/92 Artículo 8° Decreto 18/93 NIST Handbook 44
Fecha de Calibración	: 25/02/2021
Fecha de Emisión	: 08/03/2021
Fecha próxima Calibración	: ----------

Resultados de la Calibración

Número 40927

1.- Excentricidad

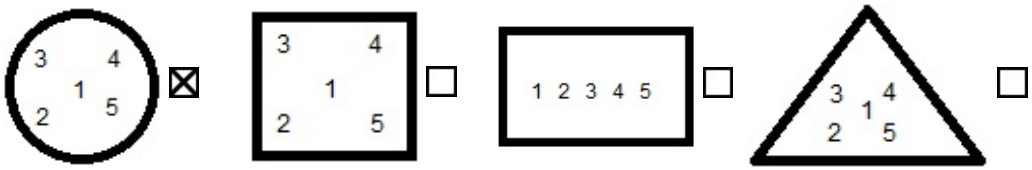

Carga de Ensayo: 20 g
Lectura Inicial (As Found).
Lectura Final (As Left).
Max. Diferencia: 0,001 g
Error Max. Permitido: 0,002 g

1	2	3	4	5	Unidad
20,000	20,000	19,999	19,999	19,999	g
20,000	20,001	20,000	20,000	20,000	g

2.- Linealidad

	1	2	3	4	5	6	Unidades
Carga Nominal	2	4	5	7	9	10	g
Lectura Inicial (As Found).	2,000	4,000	5,000	7,000	8,999	9,999	g
Lectura Final (As Left).	2,000	4,000	5,000	7,000	9,000	10,000	g
Error Balanza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	g

3.- Repetibilidad

Cargas de Prueba	5	10	--	g
Carga #	Primera Lectura	Segunda Lectura	Tercera Lectura	Unidades
1	4,999	10,000	--	g
2	5,000	10,000	--	g
3	5,000	10,000	--	g
4	5,000	10,000	--	g
5	5,000	10,000	--	g
6	5,000	10,000	--	g
7	5,000	10,000	--	g
8	5,000	10,000	--	g
9	5,000	10,000	--	g
10	5,000	10,000	--	g
Desviación Estándar	0,000	0,000	0,000	g

4.- La incertidumbre se calcula con un 95% de confiabilidad. (K=2)

	1	2	3	4	5	6	Unidades
Carga Nominal	2	4	5	7	9	10	g
Error balanza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	g
Error max permitido	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	+/-g
Incertidumbre	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	+/-g

5.- Observaciones:

Sin observaciones

Los resultados contenidos en el presente certificado, se refieren al momento y condiciones en que se realizó la calibración.

Los resultados sólo están relacionados con los ítemes calibrados.

El equipo ha sido calibrado aplicando el método directo y CUMPLE con los requisitos de la norma internacional OIML R 76-1 (Edición 2006) y la norma Chilena NCH 2562.

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al sistema internacional (SI).

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por el mal empleo del instrumento o patrón.

Revisado por: SOLEDAD ESPINOSA

Calibrado por: DIEGO ABARCA

SUBGERENTE DE SERVICIOS: LEONIDAS ENRIQUE LAZO

El contenido de este certificado sólo puede ser reproducido en forma completa