

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Cliente : PROMAIZ S.A.
Dirección : AV. JAIME GUZMAN S/N KM 7,5 LOTE 3
Comuna : ISLA DE MAIPO

IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO

Fabricado por : QUANTUM
Modelo : QT-235
Número de serie : 12539
Número Interno : N/A
Plataforma modelo : BALANZA ELECTRONICA
Capacidad Máxima : 300 kg
Capacidad Mínima : 1 kg
Rango de utilización : 1 kg hasta 25 kg
Escalafón Real d : 0,05 kg
Escalafón de Verificación e : 0,05 kg
Clasificación OIML : Tres (III)
Instalada en : SILO
Sello de Calibración : 72.255

TRAZABILIDAD DE LA MEDICION Y CALIBRACION

Valor Nominal Patrón Utilizado : Set de masas de 1 g a 20 kg
Código Patrones de Trabajo : 276 / 271 / 274 / 275 / 268
Clase OIML : F2
Trazabilidad : CESMEC → LCPN-M
Según certificado número : SMA-78536 / SMA-78636 / SMA-77922
Fecha de Vigencia : 19/12/19 - 19/12/19 - 11/10/19

CONDICIONES AMBIENTALES DE CALIBRACION

Temperatura : 16,3 ± 1,3 °C
Humedad Relativa : 64 ± 5,0 %

METODO Y FECHA DE CALIBRACION

Procedimiento : P-LM-12/04
Fecha de Calibración : 28/08/2018
Fecha de Emisión : 10/09/2018

El contenido de este certificado solo puede ser reproducido en forma completa

Av. Los Cerrillos 075 • Cerrillos • Santiago • Fono/Fax: **22363 5200**
e.mail: laboratorio@covery.cl • sitio web: www.lmcsa.cl

TABLA DE RESULTADOS DE CALIBRACION

1.- Ensayo de Excentricidad (kg)

Posición	# 1	# 2	# 3	# 4	# 5	Dif. Máx.
Indic. Inicial	8,00	8,00	7,95	8,00	8,00	0,05
Indic. Final	8,00	8,00	7,95	8,00	8,00	0,05
Diferencia máxima admisible entre las distintas posiciones: 0,05						

2.- Ensayo de linealidad (kg)

Valor Nominal	Error Inicial	Error Final	Incertidumbre 95%	Error Máximo Permisible
1	0,00	0,00	$\pm$ 0,04	$\pm$ 0,05
5	0,00	0,00	$\pm$ 0,04	$\pm$ 0,05
10	0,00	0,00	$\pm$ 0,04	$\pm$ 0,05
15	0,00	0,00	$\pm$ 0,04	$\pm$ 0,05
20	0,00	0,00	$\pm$ 0,04	$\pm$ 0,05
25	0,00	0,00	$\pm$ 0,04	$\pm$ 0,05

La incertidumbre se calcula con un 95% de confiabilidad. (K=2)

3.- Ensayo de Repetibilidad (kg)

Lectura 1	Lectura 2	Lectura 3	Lectura 4	Lectura 5	Dif. Máx.	Error Máx.
8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,05
18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,05

4.- Ensayo de Discriminación (kg)

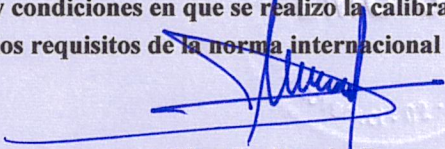
Carga mín	Sobrecarga	Indicación
1,00	0,05	1,05

Carga máx	Sobrecarga	Indicación
25,00	0,05	25,05

5.- Ensayo de Restitución de Cero (kg)

Indicación máxima observada	0,00	Indicación máxima permisible	$\pm$ 0,05
-----------------------------	------	------------------------------	------------

- Los resultados del presente certificado, se refieren al momento y condiciones en que se realizó la calibración
- El equipo ha sido calibrado según el procedimiento P-LM-12 y los requisitos de la norma internacional OIML R 76-1 edición 2006 y la norma Chilena NCh 2562.


Claudio Durán P.
Gerente Técnico

El contenido de este certificado solo puede ser reproducido en forma completa

Av. Los Cerrillos 075 • Cerrillos • Santiago • Fono/Fax: **22363 5200**
e.mail: laboratorio@covery.cl • sitio web: www.lmcsc.cl